

# FDA facilita uma maior adoção de peróxido de hidrogênio vaporizado para esterilização de dispositivos médicos

escrito por Mariana | 26 de março de 2024

Fonte: U.S Food and Drug Administration


**RELEASE FDA**

**FDA facilita uma maior adoção de peróxido de hidrogênio vaporizado para esterilização de dispositivos médicos**

A agência continua a incentivar alternativas ao Óxido de Etileno



**NASCE|CME**

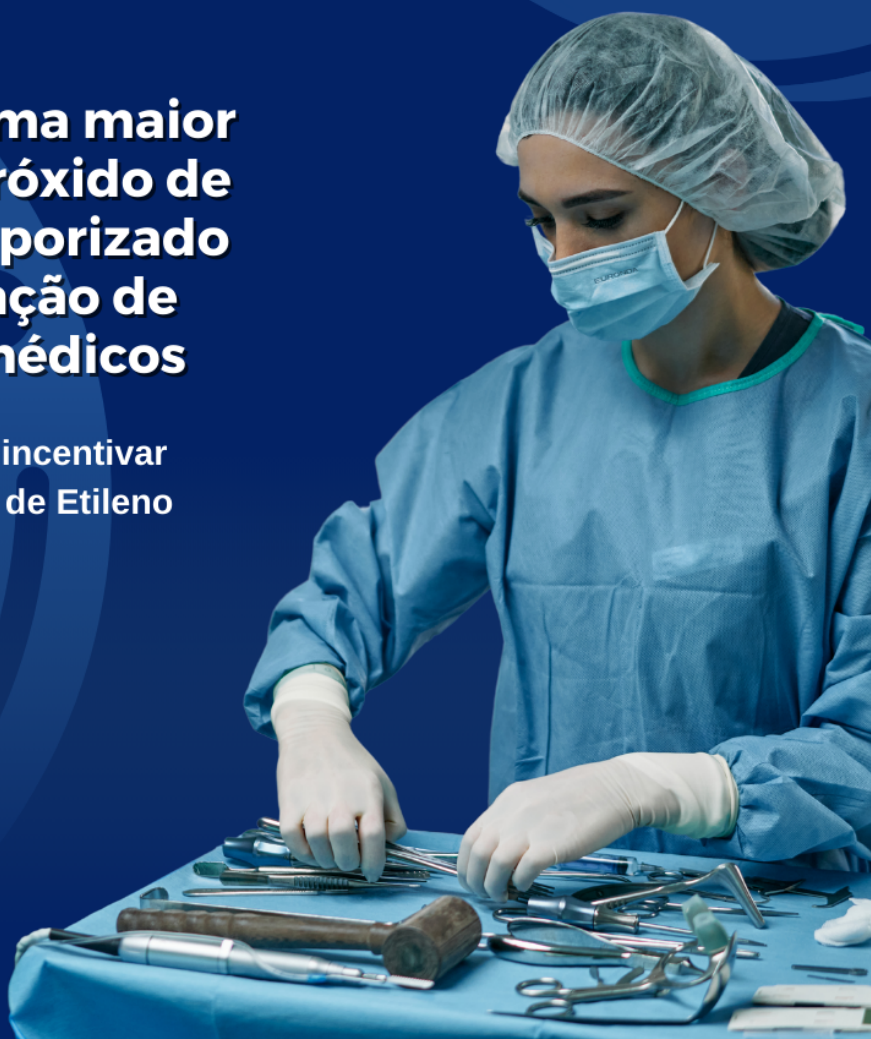

Leia a matéria completa aqui (em inglês):  
<https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-facilitates-broader-adoption-vaporized-hydrogen-peroxide-medical->

[device-sterilization](#)

